
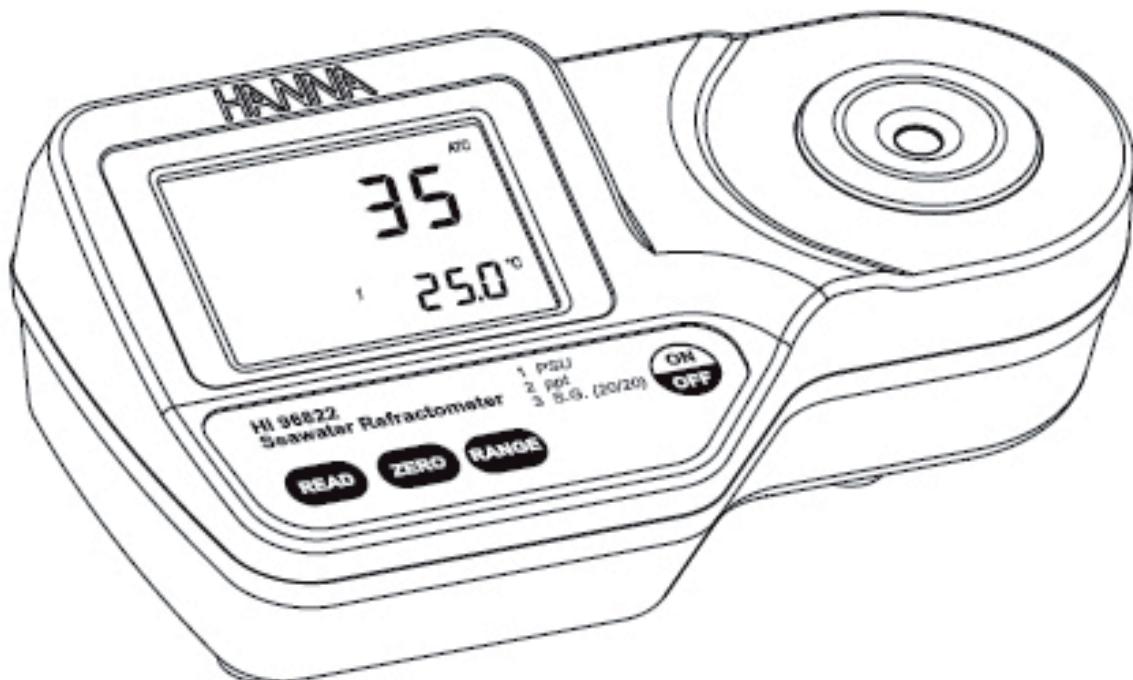


Bedienungsanleitung

HI 96822 Salz-Refraktometer für Meerwasser



Üçət: 1000000

 **HANNA**
instruments

www.hannainst.com

Sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für ein Produkt von Hanna instruments entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Anleitung gibt Ihnen die nötigen Informationen, um das Gerät korrekt zu benutzen. Das Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

INHALT

EINGANGSPRÜFUNG	2
ALLGEMEINEBESCHREIBUNG.....	3
TECHNISCHE DATEN	3
FUNKTIONSPRINZIP	4
FUNKTIONSBESCHREIBUNG.....	5
ANZEIGE	6
MESSRICHTLINIEN	6
FEHLERMELDUNGEN	7
KALIBRIERUNG	8
MESSUNG	9
HERSTELLUNEINERSTANDARDLÖSUNG	10
ÄNDERNDER TEMPERATUR EINHEIT.....	10
ÄNDERNDER MESSEINHEIT.....	11
BATTERIEWECHSEL	11
GARANTIE	11

EINGANGSPRÜFUNG

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie sorgfältig, ob es beim Transport beschädigt wurde. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung an Ihren Händler oder den nächstgelegenen HANNA Kundendienst.

Der Lieferumfang jedes HI 96822 umfasst:

- 9 V Batterie
- Bedienungsanleitung

Hinweis: Bewahren Sie die Verpackung solange auf, bis Sie sich von der ordnungsgemässen Funktion des Gerätes überzeugt haben. Defekte Geräte müssen in der Originalverpackung zurückgegeben werden.

MODELLBEZEICHNUNG

HI 96822

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung auch in Auszügen ohne die schriftliche Zustimmung des Copyright Inhabers, HANNA instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA, ist untersagt.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das HI 96822 Digital-Refraktometer für Salz ist ein robustes, tragbares und wasserfestes Gerät, bei dem HANNA die jahrelange Erfahrung als Hersteller analytischer Geräte einbringt.

HI 96822 ist ein optisches Gerät, das durch Messung des Brechungsindexes den Salzgehalt von natürlichem und künstlichem Meerwasser bestimmt. Das Verfahren ist sowohl einfach als auch schnell. Die Messung der Proben kann nach einer einfachen Kalibrierung durch den Nutzer mithilfe von deionisiertem oder destilliertem Wasser vorgenommen werden. Das Gerät misst in Sekundenschnelle den Brechungsindex der Probe und wandelt ihn in eine von 3 gängigen Salinitäts-Einheiten um: Practical Salinity Units (PSU), ppt (parts per thousand), Spezifische Gravität (S.G. 20/20). Das HI 96822 Digital-Refraktometer vermeidet die Ungewissheit mechanischer Refraktometer. Es ist tragbar und somit auch für Feldmessungen geeignet.

Die Temperatur wird gleichzeitig mit dem Messwert auf dem grossen zweigeteilten Display angezeigt, ebenso wie Symbole für den Batteriestatus und andere hilfreiche Hinweise.

Die wichtigsten Merkmale des Gerätes sind:

- Wasserdichtes Gehäuse (IP 65)
- Zweigeteiltes Display
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Einfaches Setup und einfache Lagerung

TECHNISCHE DATEN

Bereiche:	PSU:0 bis 50; ppt:0 bis 150; SG(20/20):1.000 bis 1.114; 0 bis 80 °C
Auflösung:	PSU: 1; ppt: 1; SG (20/20): 0,001; 0,1 °C
Genauigkeit:	PSU: ±2; ppt: ±2; SG(20/20): ±0,002; 0,3 °C
Temperaturkompensation:	Automatisch zwischen 10 und 40 °C
Messzeit:	ca. 1,5 Sekunden
Mindestprobengrösse:	100 µl (Prisma vollständig bedeckt)
Lichtquelle:	Gelbe LED
Probenzelle:	Edelstahlring und Flintglasprisma
Gehäusematerial:	ABS
Schutzgrad:	IP 65
Batterieart / Lebensdauer:	1 x 9 V / 5000 Messungen
Abschaltautomatik:	Nach 3 Minuten Messpause
Masse:	19,2 (B) x 10,2 (T) x 6,7 (H) cm
Gewicht:	420 g


FUNKTIONSPRINZIP

Die Salinitätsbestimmung erfolgt durch Messung des Brechungsindex von Meerwasser. Der Brechungsindex ist eine optische Eigenschaft einer Substanz und der Anzahl darin gelöster Partikel. Der Brechungsindex wird definiert als das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum zur Lichtgeschwindigkeit in der Substanz. Infolge dieser Eigenschaft wird sich das Licht "biegen", oder die Richtung ändern, wenn es sich durch eine Substanz mit einem anderen Brechungsindex bewegt. Dies wird als Brechung bezeichnet.

Beim Übergang von einem Material mit einem höheren Brechungsindex zu einem niedrigeren Brechungsindex gibt es einen kritischen Winkel, bei dem sich ein einfallender Lichtstrahl nicht mehr brechen kann, sondern stattdessen von der Zwischenfläche reflektiert wird. Mithilfe des kritischen Winkels kann der Brechungsindex anhand der folgenden Gleichung leicht berechnet werden:

$$\sin (\Theta_{\text{critical}}) = n_2/n_1$$


Wobei n_2 der Brechungsindex des Mediums geringerer Dichte, und n_1 der Brechungsindex des Mediums höherer Dichte ist.

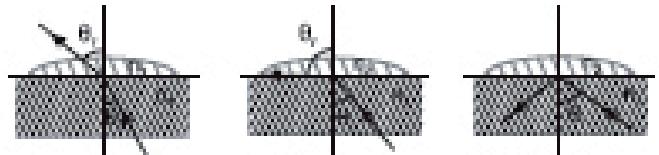

Θ_i =Einfallswinkel Brechung Kritischer Winkel Gesamte interne Reflexion
 Θ_r =Brechungswinkel $\Theta_i < \Theta_{\text{critical}}$ $\Theta_i = \Theta_{\text{critical}}$ $\Theta_i > \Theta_{\text{critical}}$
 n_1, n_2 = Brechungsindex


Bei HI 96822 geht das Licht von einer LED durch ein Prisma, welches mit der Probe in Kontakt ist. Ein Bildsensor bestimmt den kritischen Winkel, bei dem sich das Licht nicht mehr durch die Probe bricht.

HI 96822 führt bei der Messung automatisch eine Temperaturkompensation durch und wandelt den Brechungsindex der Probe in eine der gängigen Salinitäts-Einheiten um: Practical Salinity Unit (PSU), ppt oder Spezifische Gravität (SG 20/20).

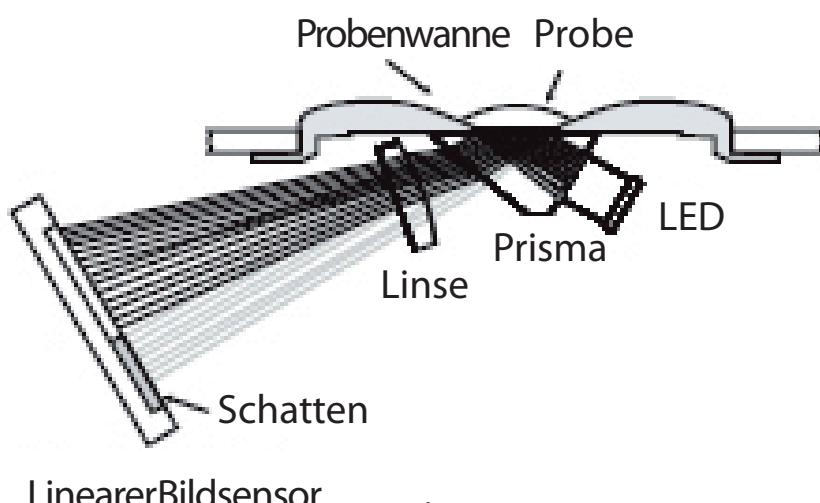

FUNKTIONSBeschreibung


ANSICHT VON OBEN

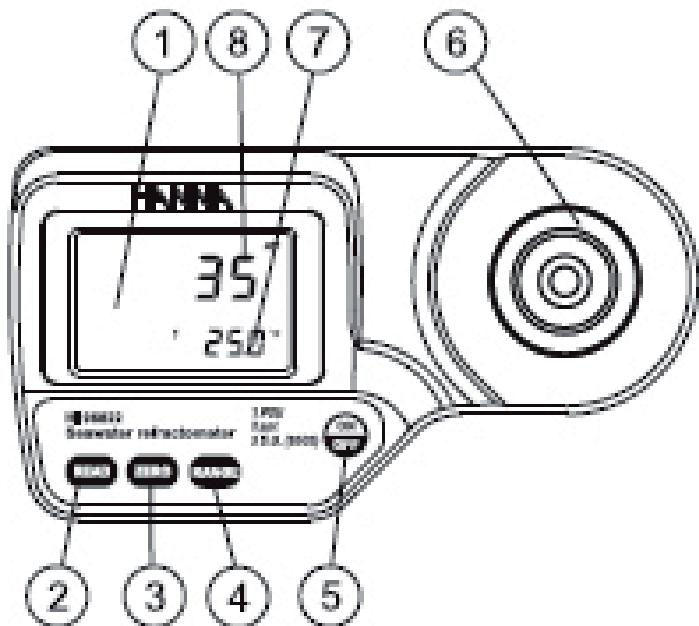


1. Display (LCD)
2. READ-Taste (Messung durch Bediener)
3. ZERO-Taste (Kalibrierung durch Bediener)
4. RANGE-Taste (Messbereich)
5. ON/OFF (Ein/Aus)
6. Edelstahlprobenwanne und Prisma
7. Nebenanzeige
8. Hauptanzeige

ANSICHT VON UNTEREN

8. Batteriefachdeckel
9. Batteriefach

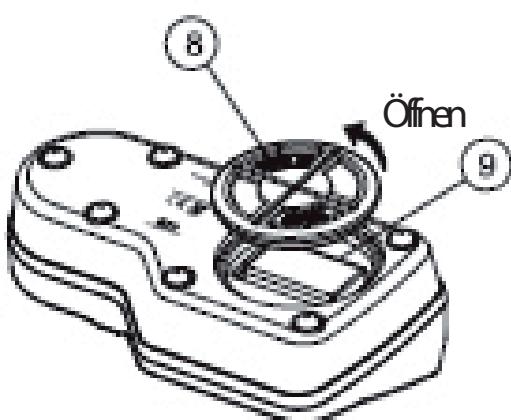

ANZEIGE

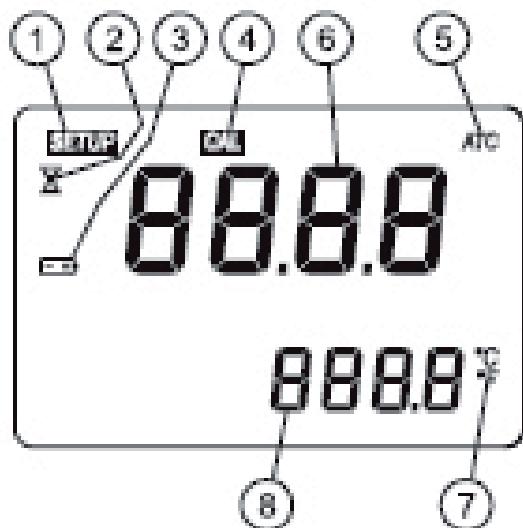

1. SETUP: Symbol für Werkskalibrierung
2. Symbol zeigt an, dass ein Messvorgang durchgeführt wird
3. Batterie (blinkt bei schwacher Batterieladung)
4. Symbol für Kalibrierung
5. Autom. Temperaturkompensation (blinkt bei Temp. außerhalb von 0-40°C)
6. Hauptanzeige (zeigt Messergebnisse und Fehlermeldungen an)
7. Temperatureinheiten
8. Nebenanzeige (zeigt Temperaturmesswerte; Blinken bedeutet Temperatur ausserhalb des Funktionsbereiches: 0 bis 80°C)

MESSRICHTLINIEN

- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Lassen Sie es nicht fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät mit Ausnahme der Probenwanne über dem Prisma vor Spritzwasser geschützt ist.
- Verwenden Sie keine Lösungen, die das Gerät oder das Prisma beschädigen könnten. Hierzu gehören die meisten organischen Lösungen sowie extrem heiße oder kalte Lösungen.
- Partikel in einer Probe können das Prisma verkratzen. Nehmen Sie die Probe mit einem weichen Tuch auf, und reinigen Sie die Probenwanne mit deionisiertem oder destilliertem Wasser, ehe Sie eine neue Probe einfüllen.
- Verwenden Sie Plastikpipetten für den Transport der Lösungen. Metallische Werkzeuge wie Nadeln, Löffel oder Pinzetten dürfen nicht verwendet werden, da diese das Prisma verkratzen können.


FEHLERMELDUNGEN

Fehlercode		Beschreibung
Err		Allgemeiner Fehler. Überprüfen Sie die Stromversorgung. Falls das Gerät weiterhin diesen Fehler meldet, wenden Sie sich an HANNA.
LO obere Anzeige		Der Probenmesswert ist niedriger als der Null-Standard, der für die Gerätekalibrierung verwendet wurde.
HI obere Anzeige		Probe überschreitet den maximalen Messbereich.
LO obere Anzeige Cal Segment an		Falsche Kalibrierung verwendet bei der Nullung des Gerätes. Verwenden Sie deionisiertes oder destilliertes Wasser. Drücken Sie die Zero Taste.
HI obere Anzeige Cal Segment an		Falsche Kalibrierung verwendet bei der Nullung des Gerätes. Verwenden Sie deionisiertes oder destilliertes Wasser. Drücken Sie die Zero Taste.
t LO obere Anzeige Cal Segment an		Temperatur unterschreitet den unteren ATC Grenzwert (0°C) bei der Kalibrierung.
t HI obere Anzeige Cal Segment an		Temperatur überschreitet den oberen ATC Grenzwert (40°C) bei der Kalibrierung.
Air		Prismenoberfläche nicht ausreichend bedeckt.
Elt		Zuviel äusseres Licht für eine Messung. Bedecken Sie die Probenwanne mit der Hand.
nLt		LED Licht nicht gefunden. Wenden Sie sich an HANNA.
Batteriesegment blinkt		<5% der Batterielebensdauer vorhanden
Blinkender Temperaturwert 0,0° oder 80,0°C		Temperaturmesswert ausserhalb des Probenbereichs (0,0 bis 80,0°C)
ATC Segment blinkt		Ausserhalb des Temperaturkompensationsbereichs (0 bis 40°C)
SETUP Segment blinkt		Werkskalibrierung ist verlorengegangen. Wenden Sie sich an HANNA.

KALIBRIERUNG

Die Kalibrierung sollte durchgeführt werden täglich, bevor Messungen erfolgen, nach Batteriewechsel oder in einer langen Messreihe.


1. Drücken Sie ON/OFF (nicht gedrückt halten). Es erscheinen kurz zwei Testbildschirme; ein LCD Segement gefolgt von der noch übrigen Batterielebensdauer in %. Danach wird kurz die gesetzte Messeinheit angezeigt. Sobald in der Anzeige Gedankenstriche erscheinen, ist das Gerät bereit.

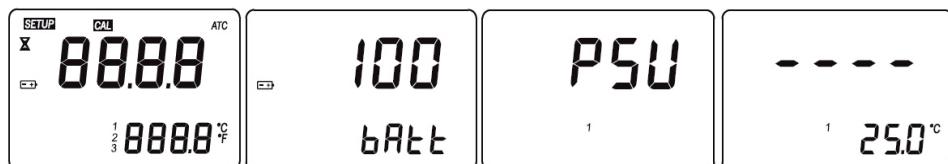

2. Füllen Sie destilliertes oder deionisiertes Wasser mithilfe von Plastikpipetten in die Probenwanne.

Hinweis: Wenn die Zero (Null)-Probe intensivem Licht wie z.B. Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt ist, muss die Probenwanne mit der Hand oder einer anderen Abschirmung während der Kalibrierung abgedeckt werden.

Destilliertes Wasser

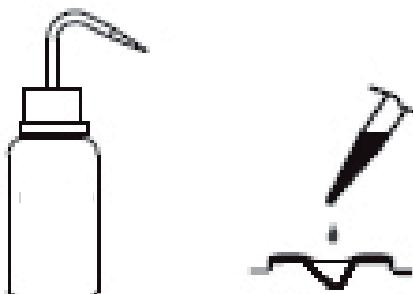

3. Drücken Sie die Zero Taste. Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wird, ist das Gerät kalibriert

(Fehlermeldungen siehe Seite 7).

Hinweis: Das Display zeigt 0 bis eine Probenmessung erfolgt oder das Gerät ausgeschaltet wird.



4. Nehmen Sie vorsichtig den Zero Wasserstandard mit einem weichen Tuch auf. Achten Sie darauf, die Prismaoberfläche nicht zu verkratzen. Wischen Sie die Oberfläche vollständig ab. Das Gerät ist für die Probenmessung bereit.

Hinweis: Die Kalibrierung geht bei Ausschalten des Gerätes nicht verloren.



MESSUNG

Überprüfen Sie vor der Vornahme von Messungen, dass das Gerät kalibriert wurde.

1. Reinigen Sie die Prismaoberfläche am Boden der Probenwanne.



2. Tropfen Sie mit Plastikpipetten die Probe auf die Prismaoberfläche. Füllen Sie die Wanne vollständig.

Hinweis: Falls die Probentemperatur sich stark von der Gerätetemperatur unterscheidet, warten Sie ca. 1 Minute, bis eine Temperaturangleichung erfolgt ist.



3. Drücken Sie die Read Taste. Der Messwert wird in der gesetzten Salinitäts-Einheit angezeigt.

Hinweis: Der letzte Messwert wird solange angezeigt, bis die nächste Messung erfolgt, oder das Gerät abgeschaltet wird. Die Temperatur wird fortlaufend aktualisiert.



Hinweis: Das ATC Symbol blinkt, und die automatische Temperaturkompensation wird deaktiviert, falls die Temperatur ausserhalb des Bereiches 0 bis 40 °C liegt.

4. Entfernen Sie die Probe aus der Probenwanne, indem Sie die Probe mit einem weichen Tuch aufnehmen.

5. Reinigen Sie das Prisma und die Probenwanne mithilfe von Plastikpipetten mit destilliertem oder deionisiertem Wasser. Trocknen Sie Prisma und Probenwanne mit einem Tuch. Das Gerät ist zur Messung der nächsten Probe bereit.



HERSTELLUNG EINER STANDARDLÖSUNG

Die Genauigkeit des Gerätes kann mithilfe einer NaCl-Lösung überprüft werden. Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die Relation zwischen NaCl-Lösung und erwartetem Salinitätswert auf.

Gehen Sie zur Herstellung einer Standard NaCl-Lösung (g/100 g) wie folgt vor:

- Stellen Sie den Behälter (z.B. ein Glasfläschchen oder eine Tropfflasche mit Deckel) auf eine Analysewaage.
- Tarieren Sie die Waage.
- Wiegen Sie zur Herstellung einer X NaCl-Lösung X Gramm hochreines getrocknetes Natriumchlorid (CAS #: 7647-14-5; MW 58:44) direkt im Behälter ab.
- Geben Sie destilliertes oder deionisiertes Wasser in den Behälter, so dass das Gesamtgewicht der Lösung 100 g beträgt.

	g NaCl	g Wasser	Gesamtgewicht	Erwarteter Salinitätswert in ppt
5% NaCl	5,00	95,00	100,00	48
10% NaCl	10,00	90,00	100,00	96
15% NaCl	15,00	85,00	100,00	145


ÄNDERN DER TEMPERATUREINHEIT

Die Temperaturmesseinheit kann wie folgt von Celsius in Fahrenheit (oder umgekehrt) geändert werden.

1. Halten Sie die ON/OFF Taste ca. 15 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheint zuerst der Bildschirm mit allen Segmenten. Dann zeigt die Hauptanzeige die Modellnummer und die Nebenanzeige die Versionsnummer an. Halten sie ON/OFF Taste weiterhin gedrückt.



2. Halten Sie ON/OFF weiterhin gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Zero Taste. Nun wechselt die Temperatureinheit von °C zu °F oder umgekehrt.

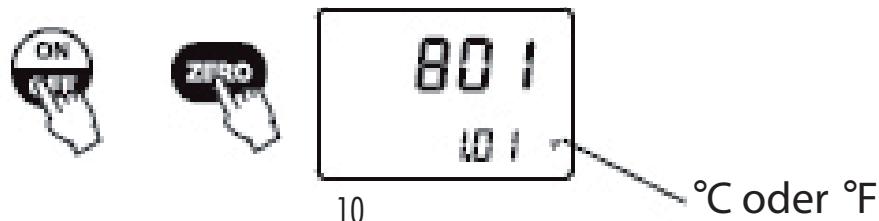

ÄNDERN DER MESSEINHEIT

Zum Setzen der gewünschten Messeinheit drücken Sie RANGE.

Durch mehrmaliges Drücken von RANGE wechselt das Gerät zwischen den verschiedenen Salinitäts-Einheiten PSU, ppt und SG hin und her. Erscheint in der Anzeige “---” ist das Gerät zur Messung bereit. Eine Ziffer im Display zeigt die gewählte Einheit an: “1” = PSU, “2” = ppt, “3” = Spezifische Gravität.




BATTERIEWECHSEL

Zum Wechseln der Batterie muss wie folgt vorgegangen werden:

- Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF Taste aus.



- Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie den Batteriefachdeckel, in dem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

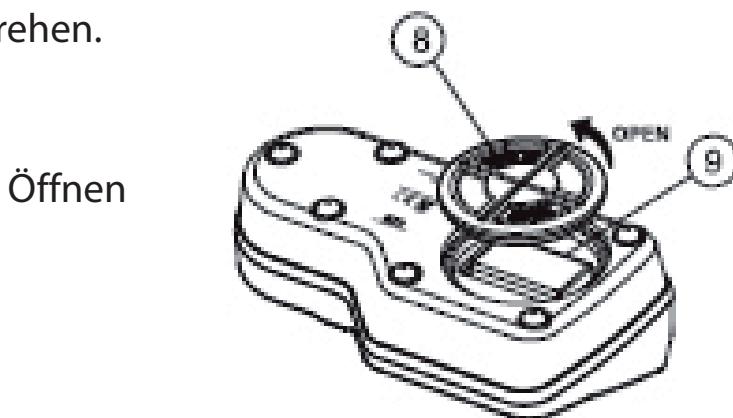

- Entnehmen Sie die Batterie.
 - Setzen Sie eine neue 9 V Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die Polarität.
 - Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein, und drehen Sie ihn in Uhrzeiger-richtung, bis er einrastet.

GARANTIE

HI 96822 besitzt eine Garantie von 2 Jahren auf Fehler in Ausführung und Material, wenn es für den beabsichtigten Zweck genutzt und nach den Anweisungen gewartet wird. Diese Garantie beschränkt sich auf die kostenlose Reparatur oder den Ersatz des Messgerätes. Schäden aufgrund von Unfällen, falschen Gebrauchs, Verstopfungen/Verschmutzungen oder Nichtbefolgen der beschriebenen Wartungsmassnahmen werden nicht abgedeckt. Wenn Sie Service wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an Ihre örtliche HANNA-Niederlassung. Bei Garantieanspruch geben Sie Modellnummer, Seriennummer, Kaufdatum und Art des Ausfalls an und schicken Sie das Gerät an:

V^AÉÍ HÉ ÁÍ Í JÁÉÉ
ØÆÄÉÍ HÉ ÁÍ Í JÁÉÉ
È { O È } È•È^
È { O È } È•È^